

COSMOS

附带浓度显示功能

气体检测部


吸引式

PD-12系列

能看到浓度，即看到了安心。

~附带显示功能，紧凑型检测部~

PD-12

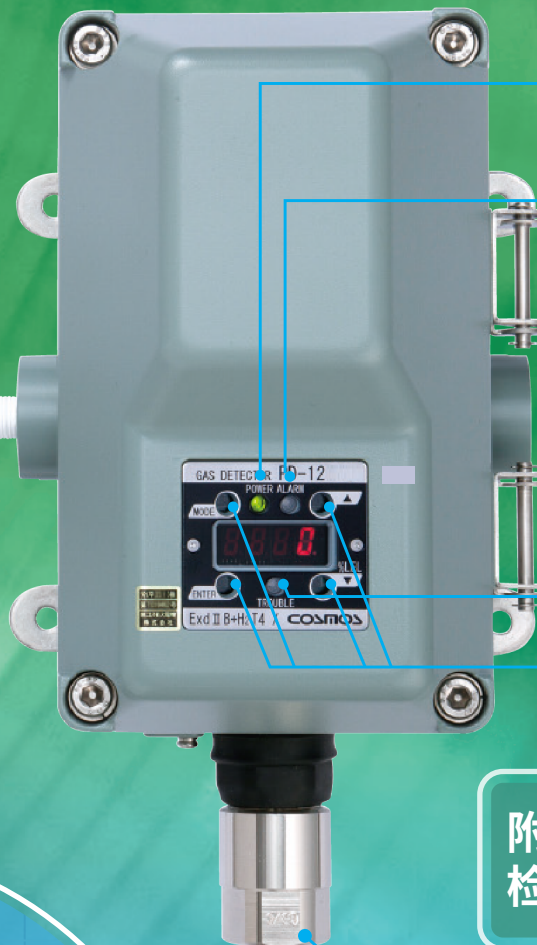

电源指示灯

报警指示灯

故障指示灯

磁性开关

附带流量低下
检测功能

线缆密封套


吸引式检测部，
对应氢气防爆！

· 现地产品

能对应各种各样用途的构成

1 能对应各种各样用途的构成

连接蜂鸣器、旋转灯,作为一体型气体检测报警器使用。



※非防爆规格,形状及规格请联系营业担当


2 连接我司的指示报警部,作为分离型气体检测报警器

包括指示报警部,检测部的设置场所中也能看到报警及浓度,确保作业员的安全。



3 连接上位系统组合使用


连接集中控制系统(DCS/PLC/SCADA等),还可在重型卡车等方向使用。

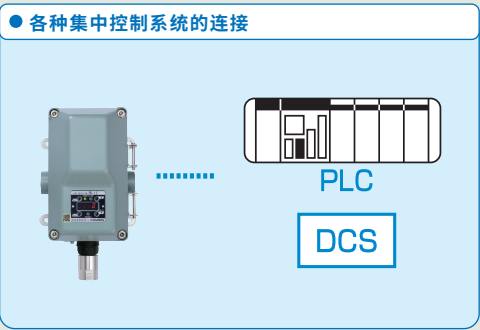


扩大了PD-12的用途

扩散式安装困难及调试困难的场合,可以选用吸引式PD-12。


恒温槽、燃烧设备等极高低温的场合

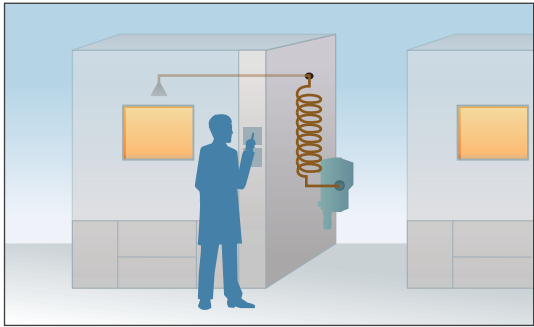

屋顶、狭隘、维护困难的场所

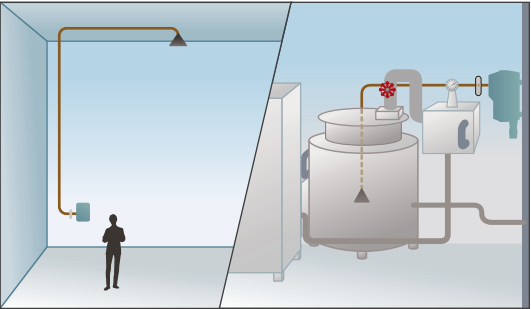

加氢站车辆加氢时的气体泄漏检测

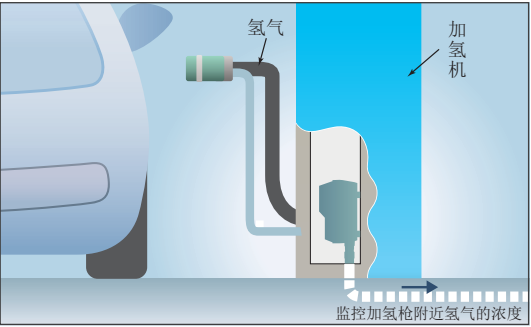

特 长

● 附带浓度、报警显示功能

在现场即可看到气体浓度、报警状态,确保了作业员的安全。

● 使用磁棒,维护方便

在现场用一根磁棒即可调整零点和量程等各种设定,简单便利。(图1)

● 相比于以往产品,更小型、轻量

实现小型化。

● 防爆构造

吸引式气体检测部PD-12跟以前的产品相比,能对应氢气防爆。施工简单,用途广的特点。
※取得了ATEX防爆认证,详细请咨询营业担当

● 附带流量低下检测功能(PD-12)

配管、过滤片堵塞引起的泵故障,流量降低到0.3L/min时发出流量低下信号,安全安心的设计(选购功能)。

● 防水、防尘构造

保护等级 IP66

● 环保的设计理念

对应无铅化及欧洲版RoHS指令。
环保的设计理念。


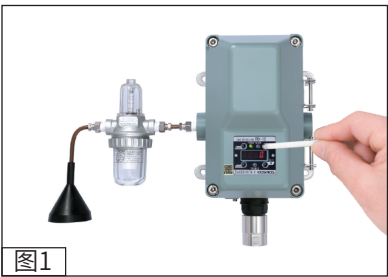


图1


一人维护,减少成本!!

■ 附带显示功能,检测部处确认即可
校正一人即可作业

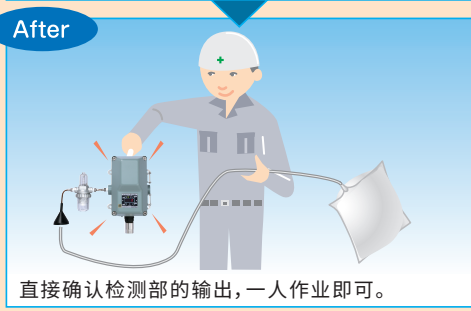


PD-12系列概要

接线口排列

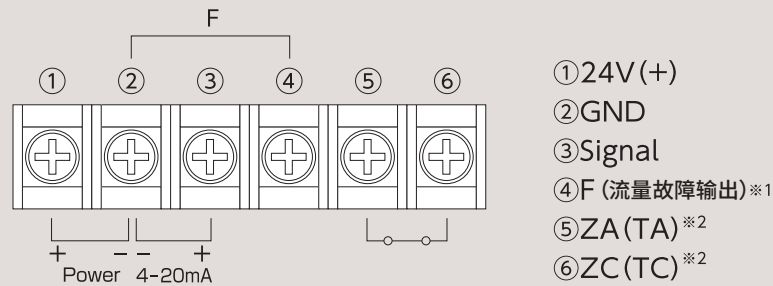

※1. 流量低下时输出(集电极开路)
※2. ZA、ZC: 气体报警接点(标准)
TA、TC: 故障接点(要指定)

PD-12外形图

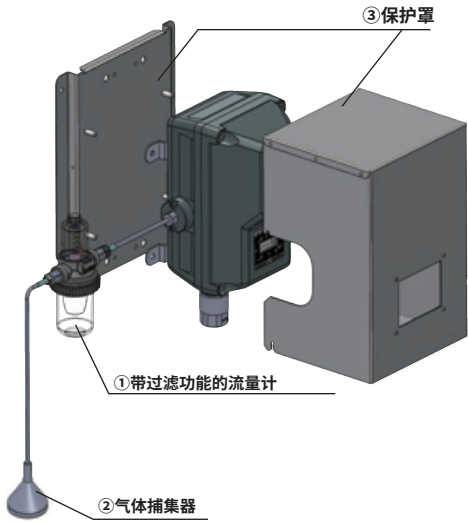

PD-12系列概要

标准附属品、选购品

标准附属品


- ①带过滤功能的流量计 (FC-32)
- ②气体捕集器 (PF-N3)

选购品


- ③保护罩 (PW-41)
保护机器免受风雨影响

排水过滤器 (AD-40)


排去采样进来的水分，
减轻传感器的影响
(根据其他用途有各种
过滤器可对应)



PD-12外形尺寸图

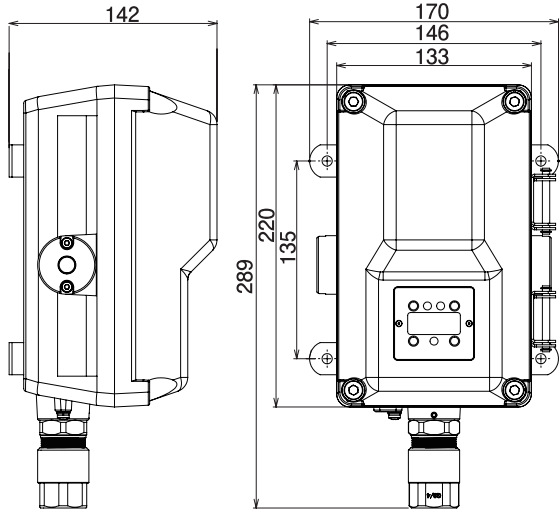

采样盘外形尺寸图

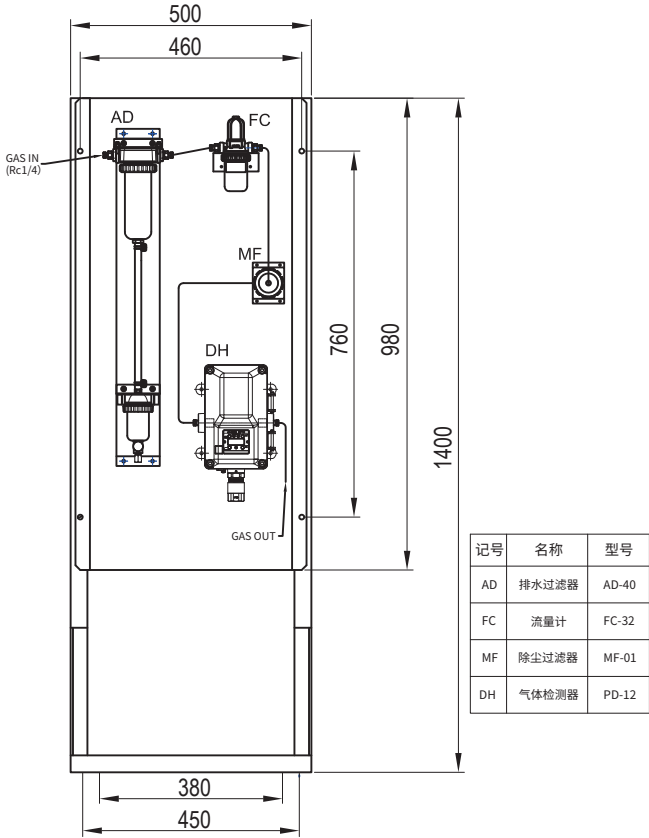

型 号	PD-12		
检 测 原 理	热线型半导体式	接触燃烧式	气体热传导式
检 测 对 象 气 体	根据规格而定		
检 测 方 式	泵吸式		
吸 引 流 量	0.5L/min以上		
检 测 范 围	根据规格而定		
报 警 设 定 值	根据规格而定		
报 警 精 度	可燃性气体：同等条件下报警设定值的±25% 毒性气体：同等条件下报警设定值的±30%		
报 警 延 迟	可燃性气体：报警设定值浓度的1.6倍气体下，反应时间30秒以内 毒性气体：报警设定值浓度的1.6倍气体下，反应时间60秒以内		
报 警 显 示	气体报警：红色LED灯闪烁 故障报警：黄色LED灯闪烁（传感器断线、传感器零点低下、电源电压异常等）		
外 部 输 出	气体浓度模拟信号：DC4~20mA(电源负极共用) 气体报警和故障接点※1 1a无电压接点/自动复位 (额定电压：AC250V 0.5A或DC30V 0.5A负载电阻)		
气 体 浓 度 显 示	LED显示屏：4位数字显示		
操 作 方 法	4点磁性开关		
防 爆 结 构	Exd II B+H ₂ T4 Gb		
保 护 等 级	IP66		
适 用 电 源 线	电源线外径：Ø11~15 6芯信号屏蔽线：CVV-S 1.25mm ² 或2.0mm ²		
使 用 温 度 湿 度 范 围	温度：-10℃~+50℃ 湿度：10~90%RH (0℃~50℃) ※2		
电 源	DC24V (±20%)		
消 耗 电 力	最大7.5W		
外 形 尺 寸	W133×H289×D132mm (突出部份除外)		
重 量	约5.2kg		

※1. 报警器接点为标准规格。作为故障接点使用时需要指定。

※2. 无剧烈的温度湿度变化，无结露。



安全须知

- 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”，并在此基础上正确使用。
- 请将检测器用于指定对象气体。如果检测器用于指定对象气体之外，则有可能造成事故发生。

为了维护检测器的性能，保证安全，
请进行日常点检及定期点检。



新考思莫施电子(上海)有限公司

NEW COSMOS ELECTRIC (SHANGHAI) CO., LTD.

—日本新宇宙在华全资子公司

上海总公司 ■ 上海市松江工业区东兴路385号4号厂房
201613 TEL: 021-6774-3138

大连分公司 ■ 大连市中山区长江路280号裕景5号楼ST2大厦3701A
(裕景国际中心)

广州分公司 ■ 广州市番禺区万博一路101号中北科创中心14层08单元

北京分公司 ■ 北京市朝阳区利泽中二路203号洛娃大厦A座1307室

成都分公司 ■ 成都市金牛区一环路北一段99号环球广场2310室

上海事务所 ■ 上海市闵行区宜山路2016号合川大厦1号楼12楼G

URL: <https://www.new-cosmos.com.cn> 中文

<https://www.new-cosmos.co.jp> 日文 & 英文

※本样册的记载内容，为了提高效率原则，变更时不予通知，请谅解。

2023年11月制作